



UBND HUYỆN PHÙ CÁT
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
Tiếp nhận hệ thống X-quang kỹ thuật số tổng quát năm 2024

Hôm nay lúc 7h00 ngày 26/02/2025, tại Phòng Giao ban khoa Chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, tiến hành họp Tổ tiếp nhận lắp đặt và nghiệm thu máy X-quang kỹ thuật số.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| 1. Ông Võ Văn Phúc | Phó Giám đốc | Tổ Trưởng |
| 2. Ông Phan Văn Phước | Khoa CĐHA | Tổ phó |
| 3. Bà Lê Thị Bích Ngọc | Phòng TC-HC | Thư ký |
| 4. Ông Trần Hữu Thọ | Khoa Dược-TTB-VTYT | |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Ngọc | Phòng TC-HC | |
| 6. Ông Võ Hà Phương | Phòng KH-NV-ĐD | |

II. NỘI DUNG:

Kiểm tra đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ dự thầu và hồ sơ máy.

III. TRIỂN KHAI

1. Theo tài liệu HSDT của Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC cam kết “*Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì và cung cấp các vật tư, phụ kiện chính hãng Máy X – quang chẩn đoán (Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát), Model PRS 500 X của hãng sản xuất PROTEC GmbH & Co. KG/Đức*”.

Tuy nhiên đối chiếu các catalogue do nhà Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Dũng (nhà phân phối) cung cấp có nhiều catalogue các máy gộp lại: PRS 500 X, CONAXX 2, RAPIXX 4343V1iX WiFi, PROTEC,... và nhiều chủng loại mã sản phẩm PRS 500 E, F, X, B, C, PROSLIDE 32 B, PROSLIDE 32 SR,...

Chúng tôi nhận thấy: Máy chính và các linh kiện, phụ kiện đa số của Trung Quốc sản xuất không phải đồng bộ chính hãng của máy Model PRS 500 X của hãng sản xuất PROTEC GmbH & Co. KG/Đức.

- Theo tài liệu HSDT của Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC “*Trong cấu hình mục A yêu cầu chung điểm 2: Nước sản xuất: Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), mục B cấu hình điểm 1: Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần*”

Tuy nhiên đối chiếu hồ sơ Công ty bàn giao:

- + Tủ NEUSOFT VENUS-50-R sản xuất tại CHINA không phải thuộc G7.
- + Trong cấu hình mục B điểm 5 bộ chuẩn trục chùm tia, tài liệu Công ty giao bộ VAREX-SN WOE050813/1-1 xuất xứ từ nước Hà Lan, không thuộc G7.
- + Trong cấu hình mục B điểm 6: Bàn bệnh nhân (mặt bàn trượt 4 hướng) không đúng với cataloge dự thầu E-HSDT
- + Tấm thu nhận ảnh DR hãng IRAY CHINA

Chúng tôi nhận thấy: tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần 3 pha với bảng điều khiển chức năng và tấm thu nhận ảnh DR nước sản xuất Trung Quốc

2. Cung cấp nhân sự có trình độ chuyên môn, được đào tạo chính hãng với hàng hoá nhà thầu tham dự thầu, hỗ trợ nhà thầu tham dự lắp đặt, bảo hành, bảo trì theo qui định của E-HSMT đảm bảo tiến độ.

Theo HSDT (thư xác nhận, HĐLĐ, bằng cấp) kỹ sư Nguyễn Xuân Trung và Ngô Mạnh Cường thực hiện công tác lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các sản phẩm máy X-quang của hãng sản xuất nhưng đến thời điểm giao máy 2 kỹ sư này không có mặt.

Kính trình, Giám đốc xem xét cho dừng lắp đặt hệ thống máy X-quang kỹ thuật số tổng quát năm 2024 thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025 do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thực hiện vì hồ sơ do nhà phân phối Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Dũng (Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC) không đúng với hồ sơ dự thầu.


Cuộc họp kết thúc lúc 8h00 cùng ngày./.

Thư ký



Lê Thị Bích Ngọc

Chủ trì

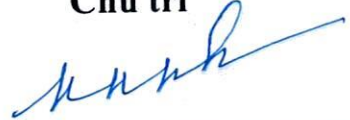

Võ Văn Phúc

Các Thành viên tham dự



Phan Văn Phước




Trần Hữu Thọ



Võ Hà Phương

Nguyễn Thanh Ngọc



Nguyễn Thanh Ngọc